# Used Products

IMPIANTO - Abutment in ossido di zirconio - Corona - Disilicato di litio - Moncone non ritentiva - SpeedCEM Plus

- [ ] **SpeedCEM Plus**
  Il cemento composito autoadesivo, autoindurente con fotopolimerizzazione facoltativa

- [ ] **OptraStick**
  Strumento per il posizionamento con punta adesiva flessibile

- [ ] **Telio CS Inlay**
  Materiale fotopolimerizzabile per otturazioni provvisorie, per la preparazioni inlay profonde a pareti parallele e per la sigillatura di aperture di  viti implantari

- [ ] **OptraGate**
  Esso consente di mantenere completamente retratte labbra e guance e di garantire un campo operatorio asciutto

- [ ] **Ivoclean**
  La pasta detergente universale Ivoclean deterge efficacemente le superfici adesive dei restauri prostetici dopo la messa in prova intraorale.

- [ ] **Monobond Plus**
  Monobond Plus è un primer monocomponente universale con tutti i materiali da restauro indiretti

- [ ] **Liquid Strip**
  Gel alla glicerina per impedire la formazione dello strato inibito da ossigeno nei compositi durante la cementazione di restauri in composito o ceramica

- [ ] **OptraPol**
  OptraPol il sistema ideale per la rifinitura e lucidatura di tutti i materiali compositi convenzionali in un'unica fase di lavoro

- [ ] **Cervitec Plus**
  Cervitec Plus è una lacca protettiva contiene Clorexidina e Timolo come componenti antimicrobici attivi in grado di ridurre l'attività della placca batterica proteggendo le superfici dentarie

# Flowchart SpeedCEM Plus

IMPIANTO - Abutment in ossido di zirconio - Corona - Disilicato di litio - Moncone non ritentiva - SpeedCEM Plus

## 1 Situazione iniziale

Avvitare l’abutment.

## 2 Messa in prova del restauro

Messa in prova del restauro definitivo. Controllare ora l’effetto cromatico, l’adattamento e l’occlusione del restauro.

## 3 Detersione e chiusura del canale filettato

Detergere a fondo il canale filettato dell’abutment con spray d’acqua e asciugare con soffio d’aria privo di acqua e di olio. Successivamente sigillare il canale filettato dell’abutment con cotone, o batuffolino di spugna assorbente e **Telio CS Inlay**. Per le successive fasi del trattamento è necessario garantire un completo isolamento del campo operatorio, p.e. con OptraGate. E’ previsto l’uso opzionale di un filo di retrazione.

## 4 Trattamento superficiale del restauro

Mordenzare con acido fluoridrico al 5% (p.es. **IPS Ceramic gel** mordenzante) per 20 secondi.

Applicare **Monobond Plus** con un pennellino oppure un microbrush sulle superfici pretrattate, lasciare agire per 60 secondi, quindi distribuire con forte getto d'aria.

## 5 Applicazione di SpeedCEM Plus

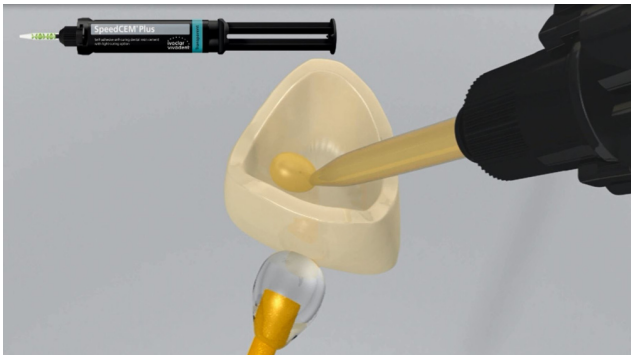

Estrudere **SpeedCEM Plus** dalla siringa automiscelante e applicarlo nella quantità desiderata direttamente sulla superficie da unire del restauro.

## 6 Cementazione del restauro e rimozione del cemento in eccesso

Posizionare il restauro in situ e mantenerlo fermo esercitando una pressione costante.

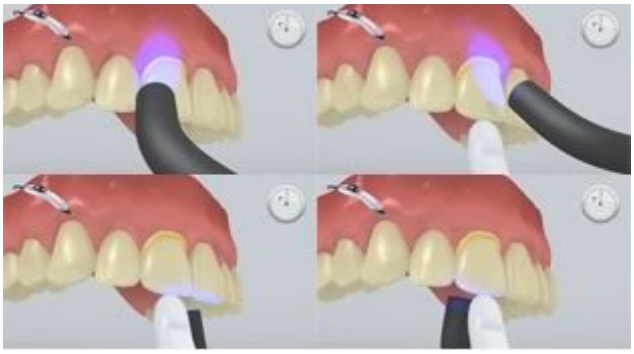

Le eccedenze di cemento si fotoattivano con lampada polimerizzante (circa 650 mW/cm$^2$), per 1 secondi a lato (mesio-orale, disto-orale, mesio-buccale, disto-buccale) ad una distanza di circa 0-10 mm.

Le eccedenze allo stato gelatinoso possono essere rimosse agevolmente con uno scaler per impianti.

Come ogni composito, anche **SpeedCEM Plus** è soggetto ad inibizione da ossigeno. Per evitare la formazione di uno strato inibito, si consiglia di coprire i margini del restauro con gel alla glicerina/airblock (p.es. **Liquid Strip**) subito dopo aver rimosso le eccedenze di cemento.

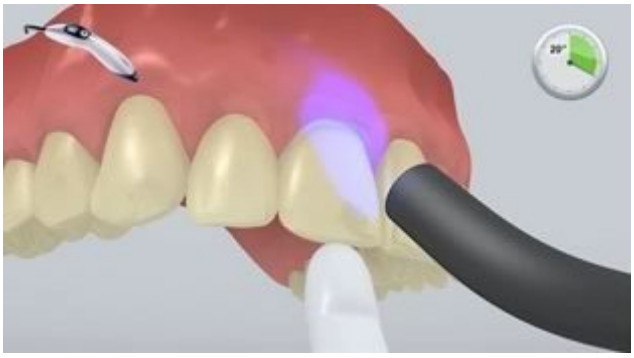

Successivamente fotopolimerizzare tutte i margini del restauro per 20 secondi (ca. 1,100 mW/ cm$^2$). Nei materiali da restauro opachi, che non si lasciano penetrare dalla luce, attendere il processo di autoindurimento.

Rimuovere **Liquid Strip** con getto d’acqua ed eventualmente togliere OptraGate, cuscinetti e fili retrattori.

## 7 Rifinitura del restauro ultimato

Rifinire le aree interprossimali con strisce per rifinitura e lucidatura. Controllare l’occlusione e i movimenti funzionali ed eventualmente apportare le necessarie correzioni. Lucidare i margini del restauro con gommini (**OptraPol**) o dischi.

## 8 Cura professionale

Applicare in modo mirato un sottile strato di**Cervitec Plus** con un applicatore Vivadent o un pennellino. Lasciare asciugare la lacca o asciugare con un getto d’aria.